


水銀使用製品は ごみステーションに 出さないでください

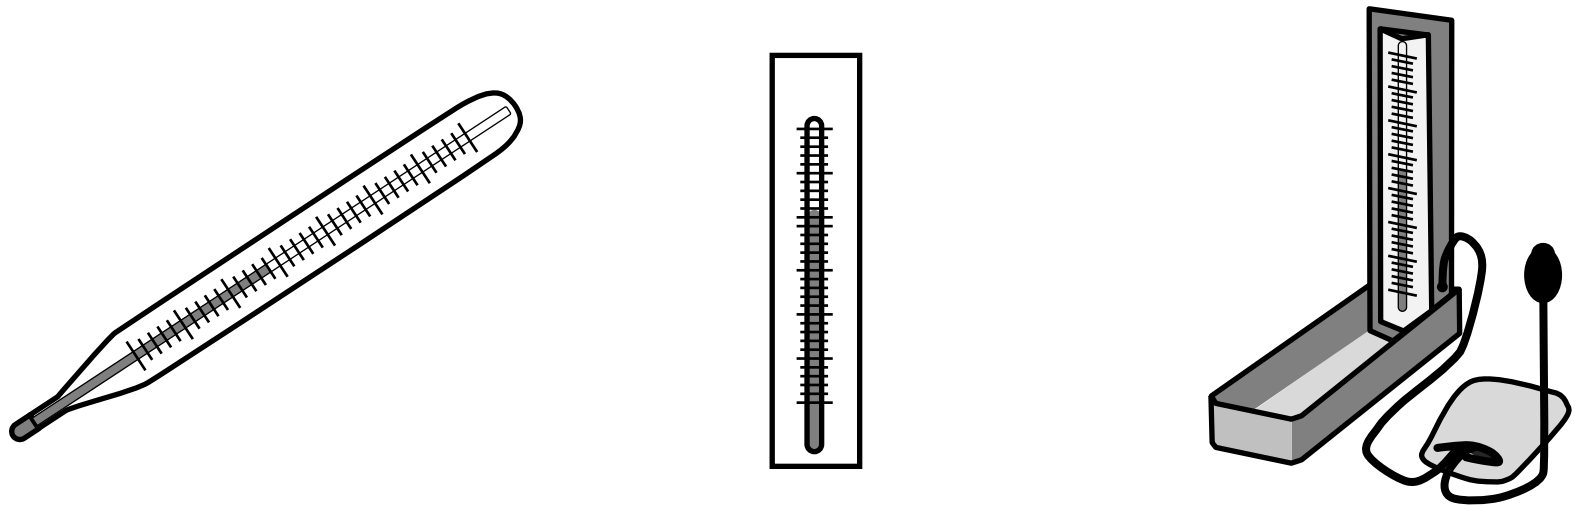

目盛内の【液が銀色】の体温計・温度計・血圧計は水銀が使用されています。

収集時の破損による被害や、ごみ処理施設の異常停止の原因になります。

市民センター等にある回収ボックス

を使用してください。



回収場所はこちら

